



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

RF-EXPLORER/3

Bestell-Nr. 25.4670

Deutsch

HF-Spektrum-Analysator

Diese Anleitung richtet sich an Bediener mit Grundkenntnissen in der HF-Technik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das €-Zeichen.



Vorsicht bei hoher EM-Einstrahlung

Mit dem RF-EXPLORER können sehr kleine Signale bis -120 dBm gemessen werden. Darum sind die Antenneneingänge sehr empfindlich und können durch eine zu hohe Einstrahlung **auch bei ausgeschaltetem Gerät** beschädigt werden. Der maximale Eingangsspegel von +5 dBm darf nicht überschritten werden. Dieser ergibt sich z.B. bei einem Abstand von ca. 1 m zu einem Mikrowellenherd oder von ca. 10 cm zu einem Mobiltelefon.

Es müssen auch unbedingt statischen Entladungen über die Antennen vermieden werden. Fassen Sie z.B. das Metallgehäuse mit einer Hand fest an, bevor Sie mit der anderen Hand eine Antenne aufstecken oder berühren.

- Zur Lagerung oder zum Transport das Gerät in einer Metallbox aufbewahren und/oder die Antennen abnehmen.

- In Bereichen mit sehr hoher HF-Strahlung auf die Antennenbuchsen je einen SMA-Stecker mit einem 50-Ω-Abschlusswiderstand stecken (z.B. den Artikel SMA-150AW von MONACOR).

• Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztemperaturbereich beträgt 0–40°C.

• Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, auf keinen Fall Wasser oder Chemikalien.

• Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht richtig bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Defekte Akkus dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Geben Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung nur in den Sondermüll (z.B. Sammelbehälter bei Ihrem Fachhändler).

2 Übersicht

Der RF-EXPLORER ist für eine einfache und intuitive Benutzung konstruiert. Es muss keine umfangreiche Bedienungsanleitung durchgearbeitet werden, um die hochentwickelte Funktionsvielfalt nutzen zu können. Der größte Teil des komplexen Spektrum-Analysators wird durch die Firmware vereinfacht. Zum Beispiel müssen Sie nicht jedes Mal die Auflösungsbandbreite (RBW) einstellen, wenn eine andere Frequenz-Darstellungsbandbreite gewählt wird. Sie müssen nicht einmal wissen, was RBW ist.

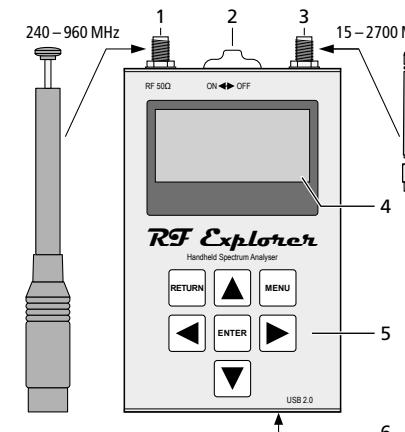


Abb. 1 Anschlüsse und Bedienelemente

- 1 Antennenbuchse für den Bereich 240–960 MHz
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Antennenbuchse für den Bereich 15 MHz–2,7 GHz
- 4 Display
- 5 Tastatur
- 6 Mini-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus (dazu den Ein-/Ausschalter in die Position ON stellen) und zur Bedienung über einen PC

3 Spektrum-Analysator-Modus Akku aufladen

Nach dem Einschalten des RF-EXPLORERS erscheinen auf dem Display nacheinander kurz Menüs mit Informationen:

RF Explorer
Spectrum Analyzer
S/N:B3B985L7K8BM8NCF
ver01.23 20-Sep-17
www.rf-explorer.com

* 240-960MHz
FACTIVE1
15-2700MHz
64KB RAM Extra found
2MB ROM Extra found

Abb. 2 Start-Menüs

Dann startet automatisch der Spektrum-Analysator-Modus:




Abb. 3 Spektrumdarstellung

Auf dem Display gibt es eine X- und eine Y-Achse:
X für die Frequenz in MHz und
Y für die Leistung in dBm.

In der Abb. 3 reicht der Frequenzbereich von 2,408 GHz bis 2,458 GHz und die Amplitude (Dynamikbereich) von -10 dBm bis -120 dBm.

Konfigurationseinstellungen wie Amplitudenreferenz und Frequenz-Darstellungsbandbreite werden zwischen den Messungen beibehalten. In der Darstellung ist eine kleine Markierung ▽ zu sehen. Diese zeigt die Spitzenamplitude in der aktuellen Frequenz-Darstellungsbandbreite. Der erste Wert gibt die Frequenz an diesem Punkt an und der zweite Wert die Amplitude.

Das Display zeigt ebenfalls ein Symbol für den USB-Anschluss (bei Anschluss an einen PC) oder ein Batteriesymbol (wenn der Ein-/Ausschalter auf ON steht). Zum Aufladen des internen Akkus den RF-EXPLORER an eine USB-Buchse anschließen; der Ein-/Ausschalter (2) muss in der Position ON stehen! Das USB- und das Batteriesymbol erscheinen dann abwechselnd.

4 Menüs

Die Bedienung erfolgt über mehrere Menüs, die nacheinander mit der Taste MENU aufgerufen werden. Mit der Taste RETURN kann von jedem Menü aus zurück auf die Spektrumdarstellung geschaltet werden.

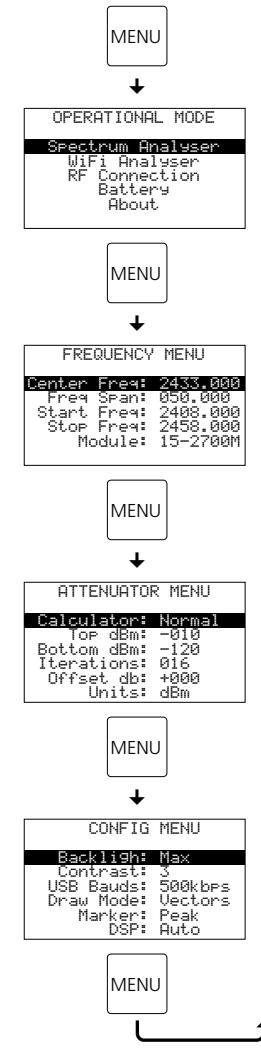


Abb. 4 Menüstruktur

4.1 Menü Operation Mode

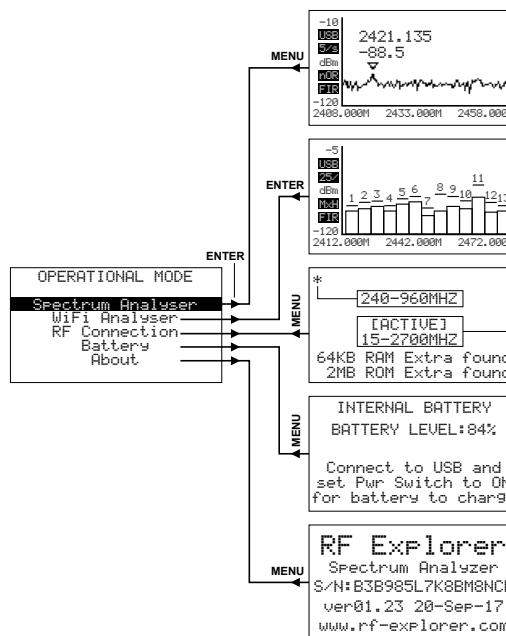


Abb. 5 Menü Operational Mode

Um das Menü OPERATIONAL MODE (Betriebsart) aufzurufen, die Taste MENU (mehrfach) drücken. Die gewünschte Funktion mit der Taste ▼ oder ▲ auswählen und mit der Taste ENTER aufrufen:

Spectrum Analyser: Spektrum-Analysator-Betrieb (Kapitel 4.2–4.4)

WiFi Analyser: WiFi-Analysator-Betrieb (Kapitel 5)
Diese Menüzeile ist nur vorhanden, wenn im Frequenzmenü in der unteren Zeile „Module“ der Frequenzbereich „15–2700M“ gewählt ist (Kapitel 4.2).

RF Connection: Anzeige des aktiven Frequenzbereichs (240–960 MHz oder 15–2700 MHz, Kapitel 4.2), mit Zuordnung der Antennenbuchsen sowie Anzeige der Speichergröße

Battery: Anzeige der Akkuladung

About: Anzeige von Informationen zum Gerät, wie z.B. Serien-Nr. und Firmware-Version

4.2 Frequenzmenü




Abb. 6 Frequenzmenü

Dieses Menü, mit dem Frequenzeinstellungen geändert werden können, ist wahrscheinlich das am meisten verwendete Menü.

Wenn nach dem Einschalten des RF-EXPLORERS während der Spektrumdarstellung zweimal die Taste MENU gedrückt wird, erscheint das Frequenzmenü. Dieses Verhalten ändert sich jedoch anschließend. Jedes Mal, wenn während der Spektrumdarstellung die Taste MENU gedrückt wird, erscheint das zuletzt aufgerufene Menü. So wird Zeit gespart, da nicht durch alle Menüs navigiert werden muss, um zur vorherigen Stelle zu gelangen.

Der in der Spektrumdarstellung gezeigte Frequenzbereich kann auf zwei unterschiedliche Methoden geändert werden:

1. Center Freq und Freq Span

Dies ist die übliche Spektrum-Analysator-Einstellung, die allen Fachleuten vertraut ist. Es wird die Mittenfrequenz (Center Freq) des zu analysierenden Frequenzbands eingestellt und dann die Bandbreite (Freq Span).

2. Start Freq und Stop Freq

Diese anwenderfreundliche Methode bietet nur wenige Spektrum-Analysatoren. Es wird die untere Frequenz (Start Freq) und die obere Frequenz (Stop Freq) des zu analysierenden Frequenzbands eingestellt.

Wenn Center Freq und Freq Span eingestellt werden, ändern sich entsprechend Start und Stop Freq und umgekehrt. Im Allgemeinen werden Center Freq/Freq Span eingestellt, wenn die Frequenz bekannt ist und Start/Stop Freq, um einen bestimmten Bereich zu überprüfen.

Um zu einer Option zu gelangen, die Tasten ▲ und ▼ verwenden. Dann die Taste ENTER drücken, um die Option editieren zu können. Mit der Taste ◀ oder ▶ zu der Stelle gehen, die geändert werden soll. Mit der Taste ▲ oder ▼ den gewünschten Wert einstellen und die Einstellung mit der Taste ENTER bestätigen oder mit der Taste RETURN zurücknehmen.

In der Zeile **Module** lässt sich der zu analysierende Frequenzbereich (240–960 MHz oder 15–2700 MHz) mit der Taste ENTER umschalten. Nach dem Umschalten zeigt das Display kurz den aktiven Frequenzbereich mit der Belegung der Antennenbuchsen an:




Abb. 7 Anzeige des aktiven Frequenzbereichs, hier 15–2700 MHz

Danach schaltet das Display automatisch zurück auf das Frequenzmenü.

Hinweis: Die Bandbreite lässt sich zwischen 0,112 MHz und 600 MHz einstellen. Die einstellbare niedrigste und einstellbare höchste Frequenz ist von den Einstellungen in den Menüzeilen „Freq Span“ und „Module“ abhängig.

Beispiel für die Änderung der Bandbreite von 9 MHz auf 6,5 MHz; die untere und obere Frequenz werden dabei automatisch aktualisiert:





Abb. 8 Bandbreite von 9 MHz auf 6,5 MHz verringern

Mit der Taste RETURN das Menü schließen und zurück auf die Spektrumdarstellung schalten.




Abb. 9 Spektrumdarstellung mit Bandbreite 6,5 MHz

Der neue Frequenzbereich ist eingestellt. Als weiteres Beispiel den Vorgang wiederholen, um die Bandbreite auf 2,5 MHz zu ändern. Dazu wieder die Taste MENU drücken: Die vorherige Menüoption (Freq Span) ist ange wählt. Den Wert auf 2,5 MHz ändern und mit der Taste ENTER bestätigen. Dann die Taste RETURN drücken, um zur Spektrumdarstellung zurückzukehren.





Abb. 10 Bandbreite auf 2,5 MHz geändert

Der neue Frequenzbereich ist eingestellt. Aber das Interessante ist jetzt, dass die Mittenfrequenz auch geändert werden kann, ohne erneut das Frequenzmenü aufrufen zu müssen. Hierzu während der Spektrumdarstellung die Taste ◀ oder ▶ (mehrfach) drücken: Die Mittenfrequenz wird jedes Mal um $\frac{1}{8}$ der Bandbreite verringert

bzw. erhöht, d.h. bei einer Bandbreite von 2,5 MHz um 0,3125 MHz mit einem einfachen Tastendruck. Diese direkte Methode ist besonders bei einer schmalen Bandbreite zweckmäßig.

Während der Spektrumdarstellung lassen sich die Messwerte und die Messkurve durch Drücken der Taste ENTER einfrieren. Das erleichtert das Ablesen bei sich schnell ändernden Werten. Neben der Y-Achse blinkt dann die Anzeige **HL**. Zum Zurückschalten auf die aktuellen Werte die Taste ENTER erneut drücken.

An der X-Achse sind die Frequenzen des Scan-Bereichs angegeben. Alternativ dazu kann die Bandbreite **SP**, die Mittenfrequenz **C** und die Auflösungsbandbreite **RBW** angezeigt werden. Zum Umschalten die Taste RETURN drücken. Wenn jetzt die Taste ◀ oder ▶ (mehrfa ch) gedrückt wird, ändert sich nicht die Mittenfrequenz, sondern die Bandbreite. So kann auch die Bandbreite schnell geändert werden, ohne das Menü aufrufen zu müssen.

4.3 Menü Abschwächung

Mit diesem Menü lässt sich die Pegeldarstellung in der Y-Achse ändern. Zum Aufrufen die Taste MENU so oft drücken, bis das Menü auf dem Display erscheint.




Abb. 11 Menü Abschwächung

Dieses Menü hat einige interessante Optionen:

Calculator: Bietet fünf Modi für die Anzeige der Pegel. Zum Ändern des Modus die Taste ENTER drücken.

Max: Es werden die Spitzenwerte von den letzten Frequenzband-Scan-Iterationen [-Durchläufen] (siehe Menüoption unten) verwendet, in diesem Fall die Spitzenwerte von den letzten 16 Scans. Dies ist der Standardmodus, mit dem sich schnell ändernde HF-Signale entdeckt werden können oder mit dem sich in schwierigen Fällen die Kanalbelegung feststellen lässt. (Der gewählte Modus wird in der Spektrumdarstellung links von der Y-Achse angezeigt, bei diesem Modus mit **[MAX]**.)

Average: Es wird der arithmetische mittlere Durchschnitt während der letzten Scan-Iterationen berechnet. Dieser Modus eignet sich besonders, um den Durchschnitt des Grundrauschens zu ermitteln und um Signale mit konstanter Frequenz und Amplitude (Continuous Wave) anzuzeigen.

(Dieser Modus wird in der Spektrumdarstellung mit **[AVG]** angezeigt.)

Overwrt: Höhere Pegelwerte überschreiben niedrigere Werte bis die Taste RETURN gedrückt oder die Mittenfrequenz mit der Taste ▲ oder ▼ geändert wird.
(Dieser Modus wird mit **OVER** angezeigt.)

Max Hold: Gleichzeitige Darstellung der aktuellen Pegel und der maximalen Pegel.
(Dieser Modus wird mit **MAXH** angezeigt.)

Normal: Keine Berechnung, laufende aktuelle Anzeige der Pegel.
(Dieser Modus wird mit **NORM** angezeigt.)

Top/Bottom dBm: Hiermit wird der Pegelmessbereich eingestellt, Top dBm für den oberen Messwert der Y-Achse und Bottom dBm für den unteren Wert. Die Differenz zwischen beiden Werten kann nicht kleiner als 10dBm werden.

Iterations: Gibt die Anzahl der Scan-Durchläufe an, um die Spitzenwerte (Calculator: Max) oder die Durchschnittswerte (Calculator: Average) zu berechnen, einstellbar von 1 bis 16. Je höher der Iterationswert, desto genauer die Berechnung, aber desto träger die Darstellung.

Offset dB: Verschiebt den gemessenen Pegel um den eingestellten Wert (± 100 dB).

Beispiel: An einer Stelle im Raum wird bei einer bestimmten Frequenz ein Pegel von -76dB gemessen. Bei einem Offset von +76dB zeigt der RF-EXPLORER dann 0dB an. Bei Messungen an anderen Stellen im Raum wird nun die Pegelabweichung zur Referenzstelle direkt in dB angezeigt.

Units: Mit der Taste ENTER kann für die Y-Achse die Einheit dBm oder dB μ V gewählt werden. In der Spektrumdarstellung wird die gewählte Einheit mit dBm oder dBV neben der Y-Achse angezeigt.

Für einen einfachen Test den oberen dBm-Wert auf -70dBm ändern. Dann die Taste RETURN drücken, um zur Spektrumdarstellung zurückzukehren. Der angezeigte Pegelbereich ist jetzt kleiner und das Signal auf dem Display dadurch größer, besonders das Grundrauschen:




Abb. 12 Oberen dBm-Wert um 20dB verringert

Da der obere dBm-Wert sehr häufig geändert wird, kann dieser während der Spektrumdarstellung um 5dBm mit der Taste ▲ erhöht und mit der Taste ▼ um 5dBm reduziert werden. Diese Shortcuts, zusammen mit den Tasten

◀ und ▶ zum Ändern der Mittenfrequenz, sind für Konfigurationseinstellungen in Echtzeit sehr nützlich, da kein Menü aufgerufen werden muss.

4.4 Konfigurationsmenü

Im RF-EXPLORER gibt es einige Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen das Gerät entsprechend nach Wunsch oder Anwendung eingestellt werden kann. Die Taste ENTER so oft drücken, bis das Konfigurationsmenü auf dem Display erscheint.



Abb. 13 Konfigurationsmenü

Die Optionen in diesem Menü lassen sich mit den Tasten ▲ und ▼ anwählen und durch mehrfaches Drücken der Taste ENTER einstellen.

Backlight: Hintergrundbeleuchtung für das Display: OFF, Low, Med, High, Max. Der RF-EXPLORER bietet drinnen und draußen gute Sichtbarkeit, selbst bei direktem Sonnenlicht. Bei einer geringen Hintergrundbeleuchtung wird der Akku geschont.

Contrast: 10 Kontraststufen für das Display stehen zur Verfügung.

USB Bauds: Die Voreinstellung ist 500 kbit/s, welche auch empfohlen wird. Wenn es bei der Datenübertragung zum PC Probleme gibt, was selten vorkommt, auf die langsamere Geschwindigkeit von 2,4 kBit/s wechseln. Jedoch wird dies nicht empfohlen, da die Verbindung sehr langsam wird. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit des RF-EXPLORERS und des PCs müssen übereinstimmen, um eine korrekte Verbindung zu erhalten.

Draw Mode: Bei der Einstellung „Vectors“ wird eine Pegelkurve für den gescannten Frequenzbereich angezeigt, bei der Einstellung „Fill“ zeigen einzelne Säulen den Pegel an.

Marker: Setzen einer Markierung ▽ zum Ablesen von Frequenz und Pegel an diesem Punkt

None: keine Markierung

Peak: automatische Markierung der Frequenz mit dem größten Pegel

Manual: Die Markierung lässt sich im Scan-Bereich mit den Tasten ▲ und ▼ verschieben.

DSP: Der digitale Signalprozessor des RF-EXPLORERS ist mit einem Unterprogramm ausgestattet, das uner-

wünschte Signale herausrechnet (filtert), die bei der Signalverarbeitung entstehen (u.a. Spiegelfrequenzen). Bei einer aufwendigen Filterung wird jedoch durch den hohen Rechenaufwand der Messvorgang langsamer und kurze Nutzsignale (z.B. WiFi-Signale) können nicht erkannt werden.

Zum Messen von kurzen Nutzsignalen sollte die Einstellung **Fast** gewählt werden (wird in der Spektrumdarstellung mit **FST** angezeigt) und für genaue und störungsarme Messungen die Einstellung **Filter** (Anzeige **FIR**). Bei der Einstellung **Auto** schaltet das Gerät automatisch auf die optimale Messmethode um (**FST** oder **FIR**).

5 WiFi-Analysator-Modus

Dieser Modus dient zur Anzeige der 13 WLAN-Kanäle im 2,4-GHz-Bereich. Um den Modus einschalten zu können, muss im Frequenzmenü in der Zeile „Module“ der Frequenzbereich „15–2700M“ gewählt sein (Kap. 4.2).

Zum Einschalten die Taste MENU so oft drücken, bis das Menü OPERATIONAL MODE (Abb. 5) erscheint. Mit der Taste ▲ oder ▼ die Zeile „WiFi Analyzer“ anwählen und die Taste ENTER drücken.




Abb. 14 WiFi-Analysator-Modus

6 PC-Software

Auf unserer Homepage finden Sie eine Software für Windows, mit der Sie den RF-EXPLORER von Ihrem Computer aus bedienen können. Gleichzeitig erhalten Sie damit auch eine Software für eventuelle Firmware-Aktualisierungen (RF Explorer Firmware Update Loader).

<http://www.monacor.de>

→ RF-EXPLORER/3 → Service → DOWNLOADS

(Bitte beachten, dass „Microsoft®.NET Framework v4Client Profile“ installiert werden muss.)

Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Lizenz

Die im RF-EXPLORER enthaltene Firmware ist urheberrechtlich geschützt © durch Ariel Rocholl, 2010–2013.

RF Explorer PC Client ist eine freie Software unter GPL v3, daher können Sie diese entsprechend den GPL-Bedingungen ändern, weitergeben und benutzen.

7 Technische Daten

Display: kontrastreiche LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 128 × 64 Pixels

Messbereich: 15–2700 MHz

Amplitudenauflösung: 0,5 dBm

Dynamikbereich: –120 dBm bis 0 dBm

Absolute Maximal-Eingangsleistung

linke Antennenbuchse

(240–960 MHz) +5 dBm

rechte Antennenbuchse

(15–2700 MHz): +30 dBm

Mittlerer Rauschpegel: –115 dBm (typisch)

Frequenzstabilität und

-genauigkeit: ±10 ppm (typisch) $\Delta 0,001\%$

Amplitudenstabilität und

-genauigkeit: ±3 dBm (typisch)

Frequenzauflösung: 1 kHz

Auflösungsbandbreite (RBW): automatisch 2,6–600 kHz

Antennenanschlüsse: SMA, 50 Ω
passende kalibrierte 50-Ω-Antennen im Lieferumfang

Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku, 1000 mAh,

Betriebsdauer ca. 16 h, aufladbar über den USB-Anschluss

Abmessungen: 71 × 122 × 25 mm

Gewicht: 210 g

Änderungen vorbehalten.



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

RF-EXPLORER/3

Order No. 25.7370

English

RF Spectrum Analyser

These instructions are intended for users with basic knowledge in RF technology. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Safety Notes

The unit corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with **CE**.



Caution with high EM radiation

The RF EXPLORER allows to measure very small signals down to -120 dBm. Therefore, the antenna inputs are very sensitive and may be damaged by an excessive radiation **even with the unit switched off**. The maximum input level of $+5$ dBm must not be exceeded. This level results e.g. at a distance of approx. 1 m to a microwave oven or at a distance of approx. 10 cm to a mobile phone.

It is also absolutely necessary to prevent static discharging via the antennas. For instance, firmly seize the metal housing by one hand prior to attaching or touching an antenna by the other hand.

- For storage or transport, keep the unit in a metal box and/or remove the antennas.
- In areas of very high RF radiation, connect one SMA plug each with a 50Ω terminating resistor to the antenna jacks (e.g. the item SMA-150AW from MONACOR).

- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water, splash water and high air humidity. The admissible ambient temperature range is 0 – 40°C .
- For cleaning only use a dry, soft cloth, never use chemicals or water.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly operated or not repaired in an expert way.

If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.
Do not put defective rechargeable batteries into the household waste but take them to a special waste disposal (e.g. collective container at your retailer).

2 Overview

The RF EXPLORER has been designed to be intuitive and easy to use. There is no need to read comprehensive user manuals to take full advantage of its advanced functionality. Most of the complexity inherent to the spectrum analyser is simplified by the firmware. For instance, you do not need to adjust the resolution bandwidth (RBW) each time you select a different frequency span. Actually, you do not even need to know what RBW is.

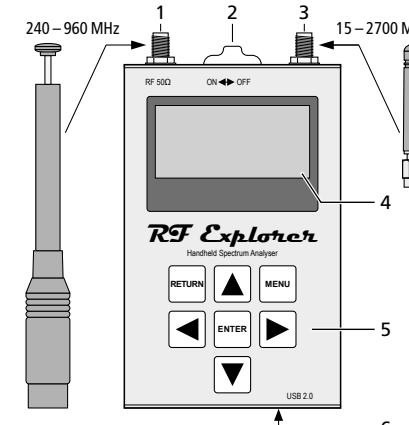


Fig. 1 Connections and operating elements

- 1 Antenna jack for the range 240–960 MHz
- 2 On/off switch
- 3 Antenna jack for the range 15 MHz–2.7 GHz
- 4 Display
- 5 Keypad
- 6 Mini USB port to charge the battery (for this purpose, set the on/off switch to position ON) and for operation via a PC

3 Spectrum Analyser Mode Recharging the battery

After switching on the RF EXPLORER, the display successively shows menus with information:

RF Explorer
Spectrum Analyzer
S/N: B3B985L7K8BM8NCF
ver01.23 20-Sep-17
www.rf-explorer.com

* 240-960MHz
ACTIVE 15-2700MHz
64KB RAM Extra found
2MB ROM Extra found

Fig. 2 Start menus

Then the spectrum analyser mode is started automatically:




Fig. 3 Spectrum display

The display shows an X axis and a Y axis, X for the frequency in MHz and Y for power in dBm.

Fig. 3 shows the frequency range from 2.408 GHz to 2.458 GHz and the amplitude (dynamic range) from -10 dBm to -120 dBm.

Configuration settings such as amplitude reference and frequency span are preserved between sessions. The display shows a small marker ∇ which indicates the peak amplitude in the current frequency span. The first value states the frequency at this point and the second value the amplitude.

The display also shows a symbol for the USB port (in case of connection to a PC) or a battery symbol (when the on/off switch is set to ON). To recharge the internal battery, connect the RF-EXPLORER/6 to a USB port; the on/off switch (2) must be in the position ON! Then the USB symbol and the battery symbol are displayed alternately.

4 Menus

The unit is operated via several menus which are successively called with the button MENU. The button RETURN allows to return from each menu to the spectrum display.

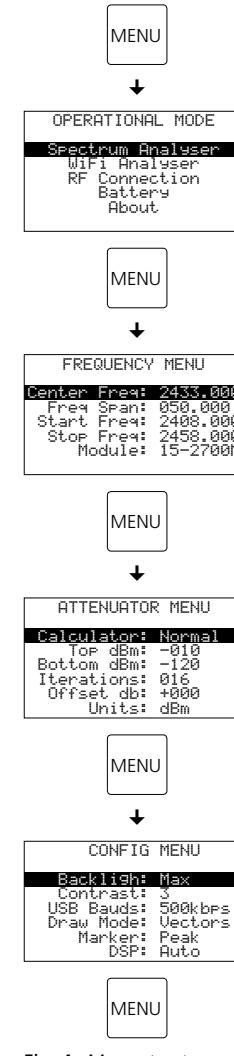


Fig. 4 Menu structure

4.1 Menu operation mode

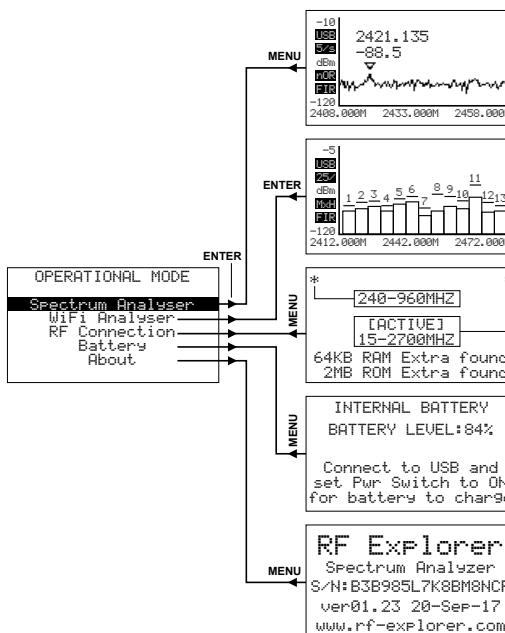


Fig. 5 Menu operational mode

To call the menu OPERATIONAL MODE, press the button MENU (repeatedly). Select the desired function using the button ▼ or ▲ and press the button ENTER to call the function.

Spectrum Analyser: spectrum analyser mode (chapters 4.2–4.4)

WiFi Analyser: Wifi analyser mode (chapter 5)
This menu line is only available if the frequency range "15–2700M" has been selected in the bottom line "Module" of the frequency menu (chapter 4.2).

RF Connection: indication of the activated frequency range (240–960 MHz or 15–2700 MHz; chapter 4.2), with the antenna jacks used and indication of memory size

Battery: battery status indication

About: indication of information relating to the unit, e.g. serial number and firmware version

4.2 Frequency menu




Fig. 6 Frequency menu

This menu which allows to change frequency settings is probably the menu most used.

When, after switching-on the RF EXPLORER, the spectrum is displayed and the button MENU is pressed twice, the frequency menu appears. However, this procedure is changed in the following. Each time the button MENU is pressed while the spectrum is displayed, the last menu called appears. Thus, time is saved as it is not necessary to navigate through all menus to return to the previous one.

There are two different methods to change the frequency range shown in the spectrum display:

1. Center Freq and Freq Span

This is the usual spectrum analyser adjustment all experts are familiar with. The center frequency (Center Freq) of the frequency band to be analysed is adjusted and then the bandwidth (Freq Span).

2. Start Freq and Stop Freq

Only a few spectrum analysers offer this user-friendly method. The lower frequency (Start Freq) and the higher frequency (Stop Freq) of the frequency range to be analysed are adjusted.

When Center Freq and Freq Span are adjusted, Start Freq and Stop Freq are changed accordingly and vice versa. In general, Center Freq/Freq Span are adjusted when the frequency is known and Start/Stop Freq to check a certain range.

To go to an option, use the buttons ▲ and ▼. Then press the button ENTER to be able to edit the option. Go to the position to be changed with the button ▲ or ▼. Adjust the desired value with the button ▲ or ▼ and confirm the adjustment with the button ENTER or cancel it with the button RETURN.

In the line **Module**, use the button ENTER to select the frequency range to be analysed (240–960 MHz or 15–2700 MHz). After selection, the display will briefly indicate the activated frequency range with the antenna jacks used:




Fig. 7 Indication of the activated frequency range (in this example: 15–2700 MHz)

Then the display will automatically return to the frequency menu.

Notes: The bandwidth can be adjusted between 0.112 MHz and 600 MHz. The lowest and the highest frequency to be adjusted depend on the settings in the menu lines "Freq Span" and "Module".

Example of a change of bandwidth from 9 MHz to 6.5 MHz; the lower and the higher frequency will be updated automatically:





Fig. 8 Reducing the bandwidth from 9 MHz to 6.5 MHz

Exit the menu with the button RETURN and return to the spectrum display.




Fig. 9 Spectrum display with bandwidth 6.5 MHz

The new frequency range is adjusted. As a further example, repeat the procedure to change the bandwidth to 2.5 MHz. For this purpose press the button MENU again: The previous menu option (Freq Span) is selected. Change the value to 2.5 MHz and confirm with the button ENTER. Then press the button RETURN to return to the spectrum display.





Fig. 10 The bandwidth is changed to 2.5 MHz

The new frequency range is adjusted but what is interesting now is that the center frequency can also be changed with no need to call the frequency menu. For this purpose press the button ▲ or ▼ (repeatedly) when the spectrum is displayed: Each time the center frequency is reduced or increased by 1/8 of the bandwidth, i.e. at a bandwidth of

2.5 MHz by 0.3125 MHz by just pressing a key. This direct method is especially useful with a narrow bandwidth.

During the spectrum display the measuring values and the measuring curve can be frozen by pressing the button ENTER. This facilitates the reading for values rapidly changing. In this case, the indication **HL** next to the Y axis is flashing. To return to the present values, press the button ENTER again.

The frequencies of the scan range are indicated at the X axis. Alternatively to this, the bandwidth **SP**, the centre frequency **C** and the resolution bandwidth **RBW** can be indicated. To switch over, press the button RETURN. When the button ▲ or ▼ is now pressed (repeatedly), it is not the centre frequency which is changed but the bandwidth. Thus, the bandwidth can also rapidly be changed without calling the menu.

4.3 Attenuator menu

This menu allows to change the level display in the Y axis. To call the menu, press the button MENU repeatedly until the menu is displayed.




Fig. 11 Attenuator menu

This menu has some interesting options:

Calculator: offers five modes for the level display. To change the mode, press the button ENTER.

Max: The peak values of the last frequency band scan iterations [sweeps] (see menu option below) are used, in this case the peak values of the last 4 scans. This is the standard mode by which rapidly changing RF signals may be detected or the channel assignment can be found in difficult cases. (The selected mode is shown in the spectrum display on the left of the Y axis, for this mode with **MAX**.)

Average: The arithmetic media average during the last scan iterations is calculated. This mode is especially suitable to find the average of the noise floor and to display signals with constant frequency and amplitude (Continuous Wave). (This mode is shown in the spectrum display with **Avg**.)

Overwrt: Higher level values overwrite lower values until the button RETURN is pressed or the center frequency is changed with the button ▲ or ▼. (This mode is shown in the spectrum display with **Overwrt**.)

Max Hold: Simultaneous display of the present levels and the maximum levels.

(This mode is shown with .)

Normal: No calculation, continuous display of the current levels.

(This mode is shown with .)

Top/Bottom dBm: Herewith the measuring range of the level is adjusted. "Top dBm" for the upper measured value of the Y axis and "Bottom dBm" for the lower value. The difference between the two values cannot be inferior to 10 dBm.

Iterations: Indicates the number of scan sweeps to calculate the peak values (calculator: max) or the average values (calculator: average), adjustable from 1 to 16. The higher the iteration value, the more exact the calculation, but the slower the display.

Offset dB: Moves the measured level by the value adjusted (± 100 dB).

Example: A level of -76 dB is measured at a certain frequency at a place in the room. With an offset of $+76$ dB the RF-EXPLORER shows 0 dB in this case. For measurements at other places in the room, the level deviation to the place of reference is directly shown in dB.

Units: The unit dBm or dB μ V can be selected for the Y axis with the button ENTER. In the spectrum display, the selected unit is shown by "dBm" or "dBV" on the left next to the Y axis.

For a simple test change the upper dBm value to -70 dBm. Then press the button RETURN to return to the spectrum display. The level range indicated is now smaller and thus the signal on the display is higher, especially the noise floor.

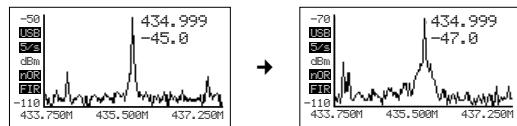


Fig. 12 Upper dBm value reduced by 20dB

As the upper dBm value is very frequently changed, this value can be increased by 5 dBm with the button \blacktriangle and be reduced by 5 dBm with the button \blacktriangledown when the spectrum is displayed. Together with the buttons \blacktriangleleft and \blacktriangleright to change the center frequency, these shortcuts are very useful for configuration adjustments in real time as there is no need to call a menu.

4.4 Configuration menu

RF EXPLORER offers some configuration facilities to adjust the unit as desired or according to application. Press the button ENTER repeatedly until the configuration menu is displayed.



Fig. 13 Configuration menu

The options in this menu can be selected with the buttons \blacktriangle and \blacktriangledown and be adjusted by pressing the button ENTER repeatedly.

Backlight: Backlight for the display: OFF, Low, Med, High, Max. The RF EXPLORER offers good visibility indoors and outdoors, even in direct sunlight. With a low backlight the battery is preserved.

Contrast: 10 contrast levels for the display are available.

USB Bauds: The presetting is 500 kbit/s which is also recommended. When problems occur during data transfer to the PC which is quite rare, change to the slower speed of 2.4 kbit/s. However, this is not recommended as the connection becomes very slow. The speed of data transfer of the RF EXPLORER must match the speed of the PC to obtain a correct connection.

Draw Mode: In case of the adjustment "Vectors" a level curve for the scanned frequency range is displayed, in case of the adjustment "Fill" individual columns show the level.

Marker: Place a marker ∇ to read frequency and level at this point.

None: no marker

Peak: automatic marking of the frequency with the highest level

Manual: The marker can be moved in the scan range with the buttons \blacktriangleleft and \blacktriangleright .

DSP: The digital signal processor of the RF-EXPLORER is equipped with a subprogram which filters unwanted signals occurring in case of signal processing (e.g. image frequencies). However, for an extensive filtering, the measuring process will become slower and short wanted signals (e.g. WiFi signals) cannot be recognized due to the high calculating effort.

To measure short wanted signals, the adjustment **Fast** should be selected (is shown by  in the spectrum display) and for exact measurements free of interference select the adjustment **Filter** (indication ). In the setting **Auto**, the unit will automatically select the most suitable measuring method ( or ).

7 Specifications

Display: high contrast LCD display with backlight, 128 x 64 pixels

Measuring ranges: 15–2700 MHz

Amplitude resolution: 0.5 dBm

Dynamic range: –120 dBm to 0 dBm

Absolute max. input power

left antenna jack (240–960 MHz): +5 dBm

right antenna jack (15–2700 MHz): +30 dBm

Medium noise level: –115 dBm (typical)

Frequency stability

and accuracy: ± 10 ppm (typical) $\Delta 0.001\%$

Amplitude stability

and accuracy: ± 3 dBm (typical)

Frequency resolution: 1 kHz

Resolution bandwidth (RBW): automatic 2.6–600 kHz

Antenna connections: SMA, 50 Ω matching calibrated 50 Ω antennas supplied

Power supply: rechargeable lithium polymer battery, 1000 mAh, operating time approx. 16 h, rechargeable via the USB port

Dimensions: 71 x 122 x 25 mm

Weight: 210 g

5 WiFi Analyser Mode

This mode serves to display the 13 WLAN channels in the 2.4 GHz range. To be able to switch on the mode, the frequency range "15–2700 MHz" must be selected in the line "Module" of the frequency menu (chapter 4.2).

To switch on, press the button MENU repeatedly until the menu OPERATIONAL MODE (fig. 5) appears. Select the line "WiFi Analyzer" with the button \blacktriangle or \blacktriangledown . Then press the button ENTER.




Fig. 14 WiFi Analyser mode

6 PC Software

On our homepage you will find a software for Windows which allows to operate the RF EXPLORER from your computer. At the same time you also receive a software for possible firmware updating (RF Explorer Firmware Update Loader).

<http://www.monacor.com>

→ RF-EXPLORER/3 → Services → DOWNLOADS

(Please note that "Microsoft®.NET Framework v4Client Profile" must be installed.)

Windows is a registered trademark of the Microsoft Corporation in the USA and other countries.

Licence

The firmware included in the RF EXPLORER is protected by copyright © by Ariel Rocholl, 2010 – 2013.

RF Explorer PC Client is a free software under GPL v3, therefore you are free to modify, distribute and use it according to GPL terms.

Subject to technical modification.



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

RF-EXPLORER/3

Réf. num. 25.7370

Français

Analyseur de spectre HF

Cette notice s'adresse aux utilisateurs avec des connaissances de base dans la technologie HF. Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1 Conseils d'utilisation

L'appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole



Attention au rayonnement EM

Avec le RF-EXPLORER, on peut mesurer de très petits signaux jusqu'à -120 dBm. Les entrées d'antenne sont donc très sensibles et peuvent être endommagées par un rayonnement trop élevé, même lorsque l'appareil est éteint. Le niveau maximal d'entrée de +5 dBm ne doit pas être dépassé. C'est le niveau par exemple à une distance de 1 m environ d'un four à micro-ondes ou une distance de 10 cm environ avec un téléphone mobile.

Il est impératif d'éviter tout déchargement statique via les antennes. Tenez, par exemple, le boîtier métallique avec une main avant de fixer ou toucher une antenne avec l'autre main.

- Pour le stockage ou le transport, mettez l'appareil dans un coffret métallique et/ou retirez les antennes.
- Dans les zones avec un rayonnement HF élevé, placez respectivement une fiche SMA mâle avec une résistance bouchon de 50Ω sur les prises d'antenne (par exemple l'article SMA-150AW de MONACOR).

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures et d'une humidité élevée de l'air. La plage de température de fonctionnement est de 0–40 °C.

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; de même, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries défectueuses dans la poubelle domestique, déposez-les dans un container spécifique ou ramenez-les à votre revendeur.

2 Eléments

Le RF-EXPLORER est conçu pour une utilisation simple et intuitive. Il n'est pas nécessaire d'avoir à lire une notice très détaillée pour pouvoir utiliser la grande multiplicité des fonctionnalités de l'appareil. La plus grande partie du complexe analyseur de spectre a été simplifiée par le Firmware. Par exemple, vous n'avez pas besoin de régler la largeur de bande de résolution (RBW) chaque fois que vous sélectionnez une largeur de bande d'affichage différente. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que RBW est.

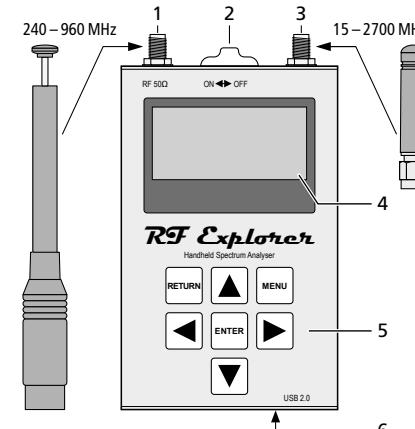


Schéma 1 Branchements et éléments

- 1 Prise d'antenne femelle pour la plage 240–960 MHz
- 2 Interrupteur marche/arrêt
- 3 Prise d'antenne femelle pour la plage 15 MHz–2,7 GHz
- 4 Affichage
- 5 Clavier
- 6 Port mini USB pour charger l'accu (mettez pour ce faire l'interrupteur marche/arrêt sur la position ON) et pour une utilisation via un PC

3 Mode analyseur de spectre Charge de l'accumulateur

Une fois le RF-EXPLORER allumé, s'affichent brièvement sur l'affichage menus avec les informations suivantes :



Schéma 2 Menus de démarrage

Ensuite le mode analyseur de spectre démarre automatiquement.




Schéma 3 Affichage spectre

Sur l'affichage, il y a un axe X et un axe Y, X pour la fréquence en MHz et Y pour la puissance en dBm.

Sur le schéma 3, la bande passante va de 2,408 GHz à 2,458 GHz et l'amplitude (plage dynamique) de -10 dBm à -120 dBm.

Les réglages de configuration tels que la référence d'amplitude et la largeur de bande d'affichage de fréquence sont conservés entre les sessions. Sur l'affichage, on peut voir un petit repère ▽. Il indique l'amplitude crête dans la largeur de bande de fréquence actuelle. La première valeur donne la fréquence à ce point et la seconde valeur l'amplitude.

L'affichage indique également un symbole pour le port USB (pour un branchement à un PC) ou un symbole de batterie (si l'interrupteur marche/arrêt est sur ON). Pour charger l'accumulateur interne, reliez le RF-EXPLORER à une prise USB ; l'interrupteur Marche/Arrêt (2) doit être sur la position ON. Les symboles USB et de batterie s'affichent en alternance.

4 Menus

L'utilisation s'effectue via plusieurs menus pouvant être appelés les uns après les autres avec la touche MENU. Avec la touche RETURN, on peut revenir de chaque menu sur l'affichage du spectre.

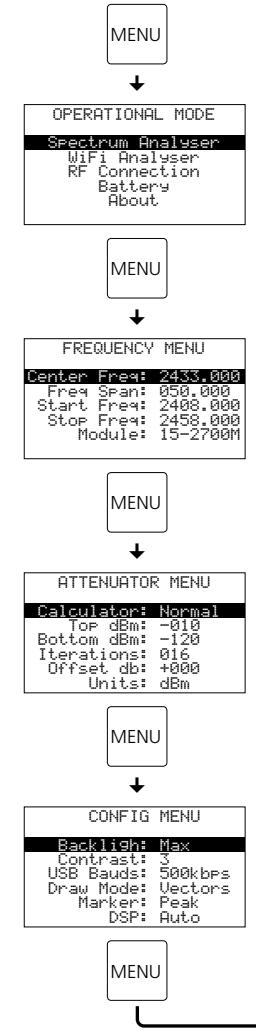


Schéma 4 Structure du menu

RETURN soit activée ou que la fréquence moyenne soit modifiée avec la touche ▲ ou ▼.
(Ce mode est affiché avec **M/H**.)

Max Hold : affichage simultané des niveaux actuels et des niveaux maxima.
(Ce mode est affiché avec **MxH**.)

Normal : pas de calcul, affichage continu des niveaux actuels
(Ce mode est affiché avec **NOR**.)

Top/Bottom dBm : la plage de mesure de niveau est réglée, «Top dBm» pour la valeur supérieure de mesure sur l'axe Y et «Bottom dBm» pour la valeur inférieure. La différence entre les deux valeurs ne peut pas être inférieure à 10 dBm.

Iterations : indique le nombre de défilements Scans pour calculer les valeurs crête (Calculator : Max) ou les valeurs moyennes (Calculator : Average), réglable de 1 à 16. Plus la valeur d'itération est importante, plus le calcul est précis mais plus l'affichage est lent.

Offset dB : déplace le niveau mesuré de la valeur réglée (±100 dB)

Exemple : à un endroit dans une pièce, un niveau de -76 dB est mesuré pour une fréquence donnée. Pour un Offset de +76 dB, le RF-EXPLORER indique alors 0 dB. Pour des mesures à d'autres endroits dans la pièce, la déviation de niveau par rapport à la position de référence est directement affichée en dB.

Units : Avec la touche ENTER, on peut régler, pour l'axe Y, l'unité dBm ou dBµV. Dans la visualisation de spectre, l'unité sélectionnée est affichée avec «dBm» ou «dBV» à gauche à côté de l'axe Y.

Pour un test simple, modifiez la valeur supérieure dBm sur -70 dBm. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir à l'affichage du spectre. La plage de niveau affichée est plus petite et ainsi le signal sur l'affichage est plus grand, en particulier le bruit de fond.

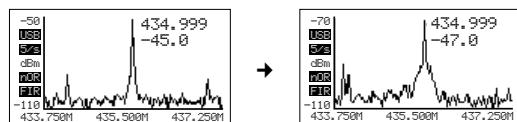


Schéma 12 Valeur dBm supérieure diminuée de 20 dB

Puisque la valeur dBm supérieure est très souvent modifiée, elle peut être augmentée de 5 dBm avec la touche ▲ et diminuée de 5 dBm avec la touche ▼ lorsque le spectre est affiché. Ces raccourcis, ensemble avec les touches ▲ et ▼ pour modifier la fréquence moyenne, sont très utiles pour les réglages de configuration en temps réel car il n'est pas nécessaire d'appeler un menu.

4.4 Menu configuration

Dans le RF-EXPLORER, quelques possibilités de configuration existent avec lesquelles l'appareil peut être réglé sur les souhaits ou types d'utilisations. Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que le menu de configuration soit visible sur l'affichage.



Schéma 13 Menu de configuration

Dans ce menu, on peut sélectionner les options avec les touches ▲ et ▼ et les régler par plusieurs pressions sur la touche ENTER.

Backlight : éclairage arrière-plan pour l'affichage : OFF, Low, Med, High, Max. Le RF-EXPLORER offre en intérieur et en extérieur une bonne lisibilité même avec une lumière directe du soleil. Avec un éclairage d'arrière-plan faible, l'accumulateur est préservé.

Contrast : 10 niveaux de contraste pour l'affichage

USB Bauds : le préréglage est de 500 kbits/s, ce qui est recommandé. Si lors de la transmission de données vers le PC, des problèmes surviennent, ce qui est rare, il faut basculer sur une vitesse plus lente de 2,4 kbits/s. Cependant, cela n'est pas recommandé puisque la connexion est très lente. La vitesse de transmission de données du RF-EXPLORER doit coïncider avec celle du PC pour obtenir une connexion correcte.

Draw Mode : avec le réglage «Vectors», on affiche une courbe de niveau pour la plage de fréquences scannée, avec le réglage «Fill», des colonnes individuelles indiquent le niveau.

Marker : placement d'un repère ▽ pour lire la fréquence et le niveau à cet endroit

None : pas de repère

Peak : repère automatique de la fréquence avec le niveau le plus élevé

Manual : on peut déplacer le repère avec les touches ▲ et ▼ dans la plage Scan.

DSP : le processeur digital de signal du RF-EXPLORER est doté d'un sous-programme qui calcule (filtre) les signaux non souhaités apparaissant lors du traitement de signal (entre autres fréquences image). Cependant, pour un filtrage complexe, le processus de mesure est plus lent et les brefs signaux utiles (par exemple signaux WiFi), ne peuvent pas être détectés à cause d'un travail plus important de calcul.

Pour mesurer de brefs signaux utiles, il faut sélectionner le réglage **Fast** (indiqué par **FST**) dans la visualisation de spectre) et pour des mesures précises et sans interférences, il faut sélectionner le réglage **Filter** (affichage **FIR**). Avec le réglage **Auto**, l'appareil sélectionne automatiquement la méthode de mesure optimale (**FST** ou **FIR**).

5 Mode analyseur WiFi

Ce mode permet d'afficher les 13 canaux WLAN dans la plage 2,4 GHz. Pour activer le mode, sélectionnez dans le menu fréquence, ligne «Module», la plage de fréquences «15–2700» (chapitre 4.2).

Pour activer, appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que le menu OPERATIONAL MODE (schéma 5) soit visible. Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la ligne «WiFi Analyzer». Appuyez ensuite sur la touche ENTER.




Schéma 14 Mode analyseur WiFi

6 Logiciel PC

Vous trouverez sur notre site un logiciel pour Windows, avec lequel vous pouvez utiliser le RF-EXPLORER depuis votre ordinateur. Simultanément, vous obtenez un logiciel pour des actualisations éventuelles du Firmware (RF Explorer Firmware Update Loader).

<http://www.monacor.com>
→ RF-EXPLORER/3 → Services → DOWNLOADS

(Attention : «Microsoft®.NET Framework v4Client Profile» doit être installé.)

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Licence

Le Firmware contenu dans le RF-EXPLORER est protégé par le copyright © par Ariel Rocholl, 2010–2013.

RF Explorer PC Client est un logiciel libre de droit sous GPL v3 ; vous pouvez donc le changer, faire passer et l'utiliser en respectant les conditions GPL.

7 Caractéristiques techniques

Affichage : affichage LCD riche en contraste, éclairage arrière-plan, 128 × 64 pixels

Plages de mesure : 15–2700 MHz

Résolution amplitude : 0,5 dBm

Plage dynamique : –120 dBm à 0 dBm

Puissance d'entrée absolue maximale

Prise d'antenne gauche (240–960 MHz) : +5 dBm

Prise d'antenne droite (15–2700 MHz) : +30 dBm

Niveau sonore moyen : –115 dBm (typique)

Stabilité et précision fréquences : ±10 ppm (typique) Δ 0,001 %

Stabilité et précision amplitude : ±3 dBm (typique)

Résolution fréquence : 1 kHz

Résolution largeur de bande (RBW) : automatique 2,6–600 kHz

Branchements antenne : . . . SMA, 50 Ω antennes 50 Ω calibrées correspondantes livrées

Alimentation : accumulateur lithium polymère, 1000 mAh, durée fonc. 16 h environ, rechargeable via port USB

Dimensions : 71 × 122 × 25 mm

Poids : 210 g

Tout droit de modification réservé.



CARTONS ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

RF-EXPLORER/3

Codice 25.7370

Italiano

Analizzatore di spettro HF

Queste istruzioni sono rivolte a utenti con conoscenze base nella tecnica high frequency (HF). Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

1 Avvertenze di sicurezza

L'apparecchio è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.



Attenzione con radiazione elettromagnetica alta

Con il RF-EXPLORER si possono misurare dei segnali molto piccoli fino a -120 dBm. Perciò gli ingressi delle antenne sono molto sensibili e possono essere danneggiati da una radiazione troppo alta **anche con l'apparecchio spento**. Il livello massimo d'ingresso di +5 dBm non deve essere superato. Esso si ottiene p.es. con una distanza di 1 m ca. da un forno a microonde, oppure di 10 cm ca. da un cellulare.

Si devono evitare assolutamente anche le scariche statiche tramite le antenne. Per esempio, afferrare bene il contenitore metallico con una mano prima di inserire o toccare un'antenna con l'altra mano.

- Per il deposito o per il trasporto tener l'apparecchio in una cassa metallica e/o staccare le antenne.
- In zone con altissima radiazione HF, inserire un connettore SMA con resistenza terminale di 50Ω in ognuna delle prese per antenne (p.es. l'articolo SMA-150AW di MONACOR).

- Usare l'apparecchio solo all'interno di locali e proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua e da alta umidità dell'aria. La temperatura d'esercizio ammessa è 0–40°C.

- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso acqua o prodotti chimici.
- Nel caso d'uso improprio, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte dell'apparecchio, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni conseguenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

Non gettare le batterie scariche o difettose nelle immondizie di casa bensì negli appositi contenitori (p.es. presso il vostro rivenditore).

2 Descrizione

Il RF-EXPLORER è stato costruito per un uso semplice e intuitivo. Non occorre studiare vaste istruzioni d'uso per poter sfruttare le molteplici funzioni sofisticate. La maggiore parte dell'analizzatore complesso di spettro è semplificato dal firmware. Per esempio, non occorre impostare ogni volta la larghezza di banda della risoluzione (RBW) quando si sceglie un'altra rappresentazione della larghezza di banda. Non è nemmeno necessario sapere che cosa è RBW.

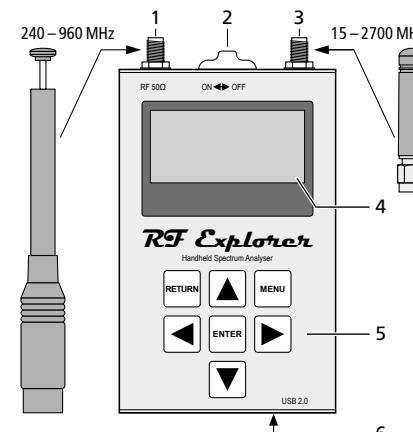


Fig. 1 Collegamento e elementi di comando

- 1 Presa per antenna per la gamma 240–960 MHz
- 2 Interruttore on/off
- 3 Presa per antenna per la gamma 15 MHz–2,7 GHz
- 4 Display
- 5 Tastiera
- 6 Contatto Mini-USB per ricaricare la batteria ricaricabile (portare l'interruttore on/off in posizione ON) e per il comando tramite un PC

3 Modo analizzatore di spettro Ricaricare la batteria

Dopo l'accensione del RF-EXPLORER, sul display si vedono brevemente uno dopo l'altro i menù con informazioni:




Fig. 2 Menu d'avvio

Quindi si avvia automaticamente il modo analizzatore di spettro:



Fig. 3 Rappresentazione dello spettro

Sul display esiste un asse X e un asse Y:
X per la frequenza in MHz e
Y per la potenza in dBm.

In fig. 3, il campo delle frequenze va da 2,408 GHz fino a 2,458 GHz e l'ampiezza (gamma dinamica) da -10 dBm fino a -120 dBm.

Le impostazioni della configurazione come la refenza dell'ampiezza e la rappresentazione della larghezza di banda delle frequenze sono mantenute fra le misurazioni. Nella rappresentazione si vede un piccolo segno ▽ che indica l'ampiezza di picco nella rappresentazione della larghezza attuale di banda. Il primo valore indica la frequenza in questo punto, e il secondo valore indica l'ampiezza.

Il display indica anche un simbolo **USB** per il contatto USB (nel caso di collegamento con un PC) oppure un simbolo di batteria **■** (se l'interruttore on/off è su ON). **Per ricaricare la batteria interna**, collegare il RF-EXPLORER con una presa USB; l'interruttore on/off (2) deve trovarsi in posizione ON! Allora appaiono alternativamente i simboli USB e batteria.

4 Menù

Il comando avviene tramite alcuni menù che si possono chiamare uno dopo l'altro con il tasto MENU. Con il tasto RETURN si può ritornare da ogni menù alla rappresentazione dello spettro.

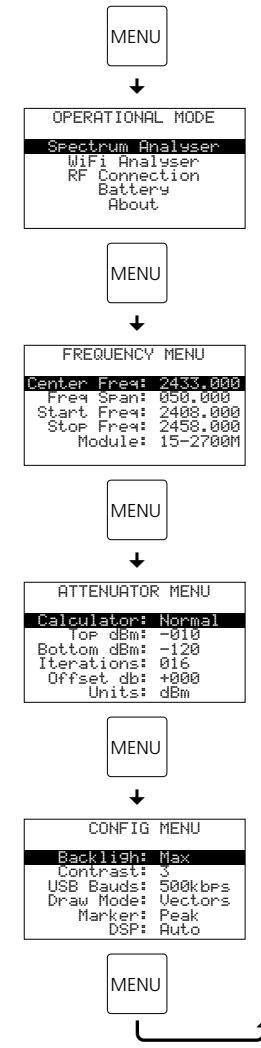


Fig. 4 Struttura del menù

4.1 Menu Operation Mode

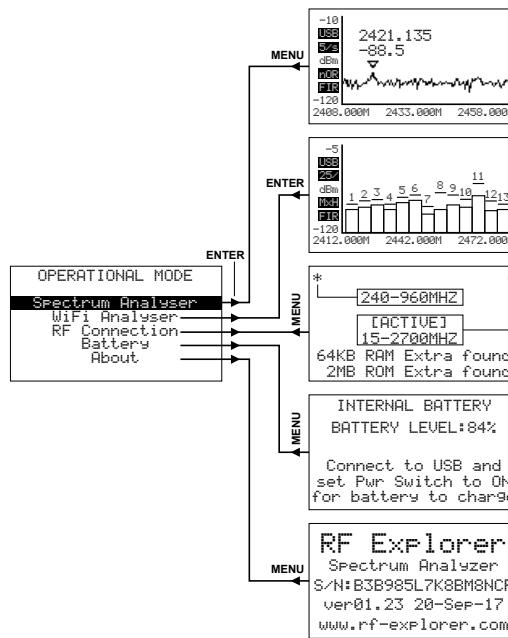


Fig. 5 Menu Operational Mode

Per aprire il menu OPERATIONAL MODE (modo di funzionamento), premere (ripetutamente) il tasto MENU. Con il tasto ▼ o ▲ scegliere la funzione richiesta e aprirla con il tasto ENTER:

Spectrum Analyser: funzionamento come analizzatore di spettro (capitoli 4.2 – 4.4)

WiFi Analyser: funzionamento come analizzatore WiFi (capitolo 5)

Questa riga del menu è disponibile solo se nel menu frequenze, alla riga inferiore "Module", è stata scelta la gamma di frequenze "15–2700M" (capitolo 4.2).

RF Connection: indicazione della gamma di frequenze attivata (240–960MHz oppure 15–2700MHz, capitolo 4.2) con assegnazione delle prese per antenne e indicazione delle dimensioni della memoria

Battery: indicazione di stato batteria

About: informazioni sull'apparecchio, come p.es. il numero di serie e versione del firmware

4.2 Menù frequenze




Fig. 6 Menù frequenze

Questo menù, con il quale si possono modificare le impostazioni delle frequenze, è probabilmente il menù usato di più.

Se dopo l'accensione del RF-EXPLORER e durante la rappresentazione dello spettro si preme due volte il tasto MENU, appare il menù delle frequenze. Tuttavia, questa reazione cambia successivamente. Ogni volta che si preme il tasto MENU durante la rappresentazione dello spettro, appare il menù chiamato per ultimo. In questo modo si risparmia del tempo dato che non occorre navigare attraverso tutti i menù per giungere al punto precedente.

La gamma di frequenze visualizzata nella rappresentazione dello spettro può essere modificata in due modi differenti:

1. Center Freq e Freq Span

Questa è l'impostazione usuale di un analizzatore di spettro come lo conoscono tutti gli esperti. S'impone la frequenza centrale (Center Freq) della banda da analizzare e quindi la larghezza di banda (Freq Span).

2. Start Freq e Stop Freq

Questo metodo molto comodo e offerto solo da pochi analizzatori di spettro. S'impone la frequenza inferiore (Start Freq) e la frequenza superiore (Stop Freq) della banda da analizzare.

Se s'impostano Center Freq e Freq Span, cambiano in corrispondenza Start e Stop Freq e viceversa. Di solito s'impone Center Freq / Freq Span se la frequenza è conosciuta, e Start / Stop Freq per controllare una determinata gamma.

Per giungere ad un'opzione, usare i tasti ▲ e ▼. Quindi premere il tasto ENTER per poter editare l'opzione. Con il tasto ▲ o ▼ muoversi sul punto da modificare. Con il tasto ▲ o ▼ impostare il valore desiderato e confermare l'impostazione con il tasto ENTER oppure cancellarla con il tasto RETURN.

Alla riga **Module**, con il tasto ENTER si può modificare la gamma di frequenze da analizzare (240–960MHz oppure 15–2700MHz). Dopo la modifica, il display indica brevemente la gamma di frequenze attivata insieme all'assegnazione della presa per antenne:




Fig. 7 Indicazione della gamma di frequenze attivata, qui: 15–2700 MHz

Dopodiché, il display ritorna automaticamente al menu delle frequenze.

N.B.: La larghezza di banda può essere impostata fra 0,112 MHz e 600 MHz. La frequenza più bassa e più alta impostabile dipende dalle impostazioni alle righe del menu "Freq Span" e "Module".

Esempio della modifica della larghezza di banda da 9 MHz a 6,5 MHz; in questo caso, la frequenza inferiore e superiore viene aggiornata automaticamente:




Fig. 8 Riduzione della larghezza di banda da 9 MHz a 6,5 MHz

Con il tasto RETURN chiudere il menù e ritornare alla rappresentazione dello spettro.




Fig. 9 Rappresentazione dello spettro con larghezza di banda 6,5 MHz

La nuova gamma di frequenze è impostata. Come esempio ulteriore, ripetere la procedura per modificare la larghezza di banda a 2,5 MHz. Per fare ciò premere nuovamente il tasto MENU: È scelta l'opzione precedente del menu (Freq Span). Cambiare il valore a 2,5 MHz e confermare con il tasto ENTER. Quindi premere il tasto RETURN per ritornare alla rappresentazione dello spettro.





Fig. 10 Larghezza di banda modificata a 2,5 MHz

La nuova gamma di frequenze è impostata, ma la cosa interessante è che ora si può modificare anche la frequenza centrale senza dovere chiamare nuovamente il menù frequenze. In questo caso, durante la rappresentazione dello spettro premere (più volte) il tasto ▲ o ▼: Ogni volta, la

freqenza centrale viene ridotta o aumentata di 1/8 della larghezza di banda, cioè, nel caso di larghezza di banda di 2,5 MHz, di 0,3125 MHz con la semplice pressione di un tasto. Questo metodo diretto è particolarmente utile con una larghezza stretta di banda.

Durante la rappresentazione dello spettro, i valori misurati e la curva delle misurazioni possono essere fissati premendo il tasto ENTER. Così è facilitata la lettura nel caso di valori che cambiano velocemente. Di fianco all'asse Y lampeggia la segnalazione **HLD**. Per ritornare ai valori attuali, premere nuovamente il tasto ENTER.

Sull'asse X sono indicate le frequenze del settore scan. In alternativa si può indicare la larghezza di banda SP, la frequenza centrale C e la banda passante di risoluzione RBW. Per cambiare, premere il tasto RETURN. Se a questo punto si preme (ripetutamente) il tasto ▲ o ▼, non cambia la frequenza centrale bensì la larghezza di banda. In questo modo è possibile variare velocemente anche la larghezza di banda senza dover aprire il menù.

4.3 Menù attenuazione

Con questo menù è possibile modificare sull'asse Y la rappresentazione del livello. Per chiamare il menù, premere il tasto MENU tante volte finché sul display appare il menù.




Fig. 11 Menù attenuazione

Questo menù ha alcune opzioni interessanti:

Calculator: Offre cinque modi per la visualizzazione del livello. Per cambiare il modo premere il tasto ENTER.

Max: Si utilizzano i valori di picco delle ultime scansioni della banda di frequenze (vedi opzioni del menu in basso), in questo caso i valori di picco delle ultime 4 scansioni. Si tratta del modo standard con il quale si possono scoprire dei segnali RF che cambiano velocemente oppure con il quale, in casi difficili, si può stabilire l'occupazione dei cavi. (Nella rappresentazione dello spettro, il modo scelto è indicato a sinistra dell'asse Y, in questo modo con **MAX**.)

Average: Viene calcolato la media aritmetica durante le ultime scansioni. Questo modo è particolarmente adatto per stabilire la media del rumore di base e per visualizzare i segnali con frequenza e ampiezza costante (continuous wave). (Nella rappresentazione dello spettro, questo modo è indicato con **Avg**.)

Overwt: I valori più alti del livello sovrascrivono i valori più bassi finché non si preme il tasto RETURN oppure finché la frequenza centrale non viene modificata con il tasto ▲ o ▼.
(Questo modo è indicato con **DUR**.)

Max Hold: Rappresentazione contemporanea dei livelli attuali e dei livelli massimi.
(Questo modo è indicato con **MxH**.)

Normal: Nessun calcolo, visualizzazione attuale dei livelli.
(Questo modo è indicato con **nDR**.)

Top/Bottom dBm: Qui s'imposta la gamma delle misurazioni del livello, "Top dBm" per il valore di misura superiore dell'asse Y e "Bottom dBm" per il valore inferiore. La differenza fra i due valori non può essere inferiore a 10 dBm.

Iterations: Indica il numero delle scansioni per calcolare i valori di picco (Calculator: Max) o i valori medi (Calculator: Average), impostabili fra 1 e 16. Più è alto il valore delle scansioni, più esatto è il calcolo, ma più lenta è la rappresentazione.

Offset dB: Sposta il livello misurato secondo il valore impostato (± 100 dB).

Esempio: In un punto della sala, con una frequenza determinata si misura un livello di -76 dB. Con un offset di +76 dB, il RF-EXPLORER indicherà 0 dB. Per le misure in altri punti della sala, la deviazione del livello rispetto al punto di riferimento sarà indicata in dB.

Units: Con il tasto ENTER, per l'asse Y si può scegliere l'unità dBm o dBmV. Nella rappresentazione dello spettro, l'unità scelta è indicata con "dBm" o "dBmV" a sinistra dell'asse Y.

Per un test semplice portare il valore dBm superiore a -70 dBm. Quindi premere il tasto RETURN per ritornare alla rappresentazione dello spettro. La gamma del livello visualizzata ora è più piccola e il segnale sul display di conseguenza è più grande, specialmente il rumore di base.




Fig. 12 Valore dBm superiore ridotto di 20 dB
Dato che il valore dBm superiore viene modificato molto spesso, durante la rappresentazione dello spettro è possibile aumentarlo di 5 dBm con il tasto ▲ e ridurlo di 5 dBm con il tasto ▼. Questi shortcut, insieme ai tasti ▲ e ▼ per modificare la frequenza centrale sono molto utili per le impostazioni della configurazione in tempo reale, visto che non si deve chiamare nessun menu.

4.4 Menù configurazione

Nel RF-EXPLORER esistono alcune possibilità di configurazione con le quali è possibile impostare l'apparecchio secondo desiderio o secondo l'applicazione. Premere il tasto ENTER tante volte finché sul display appare il menù configurazione.



Fig. 13 Menù configurazione

Le opzioni di questo menù si possono scegliere con i tasti ▲ e ▼ e si impostano con una pressione ripetuta del tasto ENTER.

Backlight: Retroilluminazione del display: OFF, Low, Med, High, Max. Il RF-EXPLORER offre all'interno come all'esterno una buona visibilità anche con la luce diretta del sole. Con una retroilluminazione ridotta si risparmia la batteria ricaricabile.

Contrast: Sono disponibili 10 livelli di contrasto per il display.

USB Bauds: La preimpostazione è di 500 kbit/s, valore da consigliare. Se ci sono dei problemi durante la trasmissione dei dati verso il PC, cosa che succede raramente, passare alla velocità minore di 2,4 kBt/s. Tuttavia ciò non è consigliabile perché il collegamento diventa molto lento. La velocità di trasmissione dati del RF-EXPLORER e del PC devono corrispondere per ottenere un collegamento corretto.

Draw Mode: Con l'impostazione "Vectors" viene visualizzata un curva del livello per tutta la gamma scansionata delle frequenze, con l'impostazione "Fill", le colonne singole indicano il livello.

Marker: Per posizionare un segno ▽ per leggere la frequenza e il livello in questo punto

None: nessun segno

Peak: posizionamento automatico del segno per la frequenza con il livello maggiore

Manual: Nella gamma delle scansioni, il segno può essere spostato con i tasti ▲ e ▼.

DSP: Il processore digitale dei segnali del RF-EXPLORER è equipaggiato con un sottoprogramma che filtra i segnali non desiderati, che si creano durante l'elaborazione dei segnali (fra gli altri, frequenze d'immagine). Con un vasto filtraggio, in seguito ai molti calcoli, la misurazione diventa più lenta e brevi segnali utili (p.es. segnali WiFi) non possono essere riconosciuti.

Per misurare brevi segnali utili, si dovrebbe scegliere l'impostazione **Fast** (indicata con **FST** nella rappresentazione dello spettro) e per delle misure precise e con poche interferenze l'impostazione **Filter** (indicazione **FIR**). Con l'impostazione **Auto**, l'apparecchio passa automaticamente al metodo migliore di misurazione (**FST** oppure **FIR**).

5 Modo analizzatore WiFi

Questo modo serve per visualizzare i 13 canali WLAN nella gamma 2,4 GHz. Per potere attivare il modo, nel menu frequenze, nella riga "Module" deve esser scelta la gamma di frequenze "15–2700 MHz" (Cap. 4.2).

Per attivare il modo, premere il tasto MENU tante volte finché appare il menù OPERATIONAL MODE (fig. 5). Con il tasto ▲ o ▼ scegliere la riga "WiFi Analyzer". Quindi premere il tasto ENTER.




Fig. 14 Modo analizzatore WiFi

6 Software per il PC

Alla nostra homepage trovate un software per Windows, con i quale comandare il RF-EXPLORER dal vostro computer. Nello stesso tempo ricevete anche un software per eventuali aggiornamenti del firmware (RF Explorer Firmware Update Loader).

<http://www.monacor.com>
→ RF-EXPLORER/3 → Services → DOWNLOADS

(Da notare che deve essere installato "Microsoft®.NET Framework v4Client Profile".)

Windows è un marchio registrato della Microsoft Corporation negli USA e in altri paesi.

Licenza

Il firmware contenuto nel RF-EXPLORER è protetto dai diritti d'autore © tramite Ariel Rocholl, 2010–2013.

RF Explorer PC Client è un software libero secondo GPL v3, perciò lo potete modificare, inoltrare a altri e usare secondo le condizioni GPL.

7 Dati tecnici

Display: a LCD con alto contrasto, con retroilluminazione, 128 × 64 pixel

Gamme di misurazione: 15–2700 MHz

Risoluzione dell'ampiezza: 0,5 dBm

Gamma dinamica: –120 dBm a 0 dBm

Potenza max. assoluta all'ingresso

Presa sinistra per antenna

(240–960 MHz): +5 dBm

Presa destra per antenna

(15–2700 MHz): +30 dBm

Livello medi di rumore: –115 dBm (tipico)

Stabilità e precisione

della frequenza: ±10 ppm (tipico) Δ 0,001 %

Stabilità e precisione

dell'ampiezza: ±3 dBm (tipico)

Risoluzione della frequenza: 1 kHz

Larghezza di banda

della risoluzione di (RBW): automatico 2,6–600 kHz

Contatti antenne: SMA, 50 Ω

antenne adatte calibrate di 50 Ω in dotazione

Alimentazione: batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 1000 mAh, durata ca. 16 h, ricaricabile tramite contatto USB

Dimensioni: 71 × 122 × 25 mm

Peso: 210 g

Con riserva di modifiche tecniche.